



TDS水質即時檢測計

使用說明書




Model


TDS-100
TDS-100S
TDS-200S
TDS-300S

安裝說明

- 1 取下透明電池絕緣片。
- 2 將TDS探頭垂直插入三通接頭內，請確認探針方向與接頭位置是否正確，如安裝圖2所示。朝向接頭孔徑內目視時，必須看見左右排列兩隻探針（非前後）以確保水流平均流過，即為正確安裝方式。
- 3 關閉RO/DI淨水機水源，以工具切斷欲安裝TDS處之RO管，再將RO管插入三通接頭連接使用。

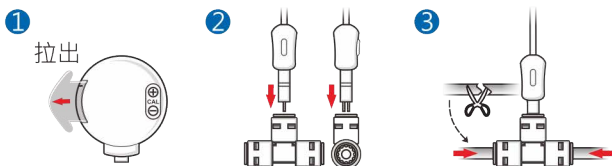

TDS水質即時檢測計說明

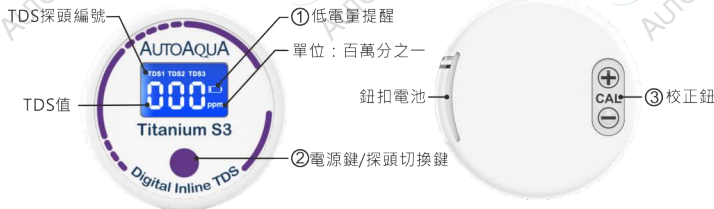

- ① 低電量提醒：當螢幕出現此圖示，請更換電池。
電池型號：CR2032。
- ② 電源鍵/探頭切換鍵使用說明：
 - i. 按一下可喚醒TDS螢幕，長按3秒可關閉TDS螢幕。若3分鐘內無任何動作，螢幕亦會自動關閉。
 - ii. 在螢幕喚醒狀態下按此按鍵，可切換至不同探頭之檢測數值（僅限S2及S3型號）。
- ③ 校正鈕：請參考"校正步驟"說明。

校正步驟

1. 請自行購買TDS檢測計專用校正液。
2. 將TDS探頭從三通接頭取下，先靜置晾乾使其乾燥。
3. 將TDS探頭放入校正液中，請確認探頭完全浸入。
4. 先按一下電源鍵喚醒TDS螢幕，再次按同一按鍵以切換至不同探頭並確認各探頭之檢測數值是否與校正液值一致 (僅S2及S3型號可切換)。若數值不一致，請依下列指示校正數值。
5. 按電源鍵切換至欲校正之探頭 (僅限S2及S3型號)。
6. 快速按兩下電源鍵始進入校正模式，此時ppm會閃爍*。
7. 按背面之校正鈕調整數值顯示與校正液值一致。
8. 按一下電源鍵完成校正**。若在15秒內無任何動作，TDS水質即時檢測計亦會自動儲存數值並回到檢測模式。

*在校正模式下，同時按 ⊕ 與 ⊖ 按鍵，TDS水質即時檢測計之所有探頭就會回復至出廠原始設定值。

**各探頭必須單獨校正。

注意事項

1. 請避免用手直接觸摸探針，以免影響檢測效果。
2. 可以酒精清潔探針，完成後使其自然乾燥。

規格

- 檢測範圍：0~999 ppm
- 精準度：+/- 2 %
- 電池規格：CR2032 鈕扣電池一顆
- 電池壽命：1 年
- 尺寸：51 公厘 x 14.5 公厘 (直徑 x 厚度)

保固條款

1. 保固服務為有限保固，僅適用於澳多科技有限公司正式授權之經銷商所販售之產品 (以下稱為“產品”)。
2. 保固服務由澳多科技有限公司授權銷售產品之經銷商權責提供。
3. 產品在正常使用情況下，自購買日起享有一年的保固服務。
4. 消費者如有保固服務需求時，需提供購買發票或證明供澳多科技有限公司及其授權之經銷商查核。

購買日期

(年/月/日)

保固期限

自購買日起一年內

銷售店家

(商店名稱/電話/email/地址)

保固服務

澳多科技有限公司
台灣新竹縣竹北市復興二路229號
7樓之7
E-mail : service@autoaqua.com.tw
www.autoaqua.com.tw

* 請至澳多科技網站取得最新經銷商資訊

